調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
収納箱，医療用		GM－T１０６１４８H	
		作　　成	平成１０年１２月１７日
		変　　更	平成２５年　９月　４日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のコンテナについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1－種類

物品番号	種類
８１１５－１００－９７６４－５	１号，４２０×３０５×２７０ mm
８１１５－１００－９７６５－５	２号，６１５×４２０×２７０ mm
８１１５－１００－９７６６－５	３号，６１５×４２０×５１６ mm
８１１５－１００－９７６７－５	４号，８３５×６１５×２７０ mm
８１１５－１００－９７６８－５	５号，８３５×６１５×５１６ mm
８１１５－１００－９７６９－５	６号，８３５×６１５×７６６ mm
８１１５－１００－９７７０－５	７号，１ ２１５×８３５×２７０ mm
８１１５－１００－９７７１－５	８号，１ ２１５×８３５×５１６ mm
８１１５－１００－９７７２－５	９号，１ ２１５×８３５×７６６ mm

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　収納箱，医療用，１号，４２０×３０５×２７０ mm

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) **規格**

ＮＤＳ Ｃ ０００２	地上用電子機器通則
ＮＤＳ Ｚ ８０１１	角形銘板
ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b) **仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 外観・塗装

外観及び塗装は，次による。

a) 外観は，きず，汚れなどがなく，仕上げが良好なものとする。

b) 収納箱の色は，無色又はＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号２３１４（ＯＤ色 ７．５Ｙ３/１）とし，塗装については，調達要領指定書によって指定する。

3.4 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

6 その他の指示

6.1 赤十字標章

赤十字標章は，次による。

a) 表示箇所は，収納箱の上面及び横４面の計５面の各面中央部とする。ただし，収納箱，医療用１号及び収納箱，医療用２号は，取っ手のある面を除く計３面の各面中央部とする。

b) 赤十字標章の形状及び寸法は，**図**1による。

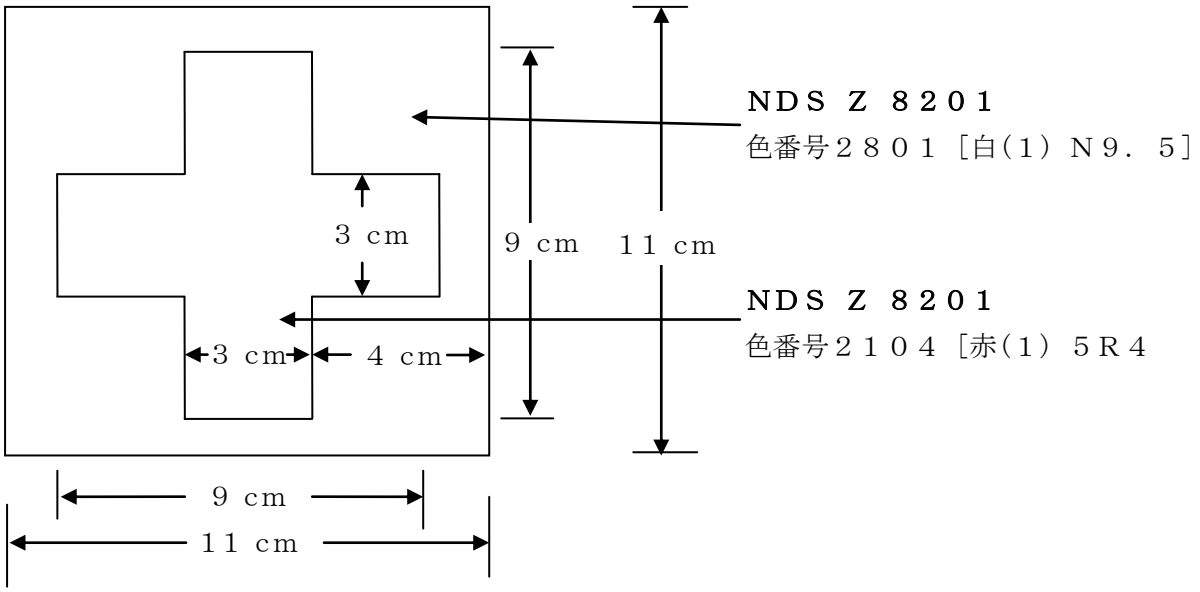

図1－赤十字標章の形状・寸法

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 取扱説明書（日本語版） 1部

b) 納入品カタログ 1部

6.2.2 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表2－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊　補給統制本部 衛生部
納入品カタログ			
試験成績表（社内検査成績書を含む。）			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM－T１０６１４８H
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　９月　４日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　**調達品目**

品名	カタログ製品名[a)]
収納箱，医療用，１号， ４２０×３０５×２７０ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45051-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9104 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，２号， ６１５×４２０×２７０ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45050-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9206 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，３号， ６１５×４２０×５１６ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45052-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9306 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，４号， ８３５×６１５×２７０ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45055-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9408 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，５号， ８３５×６１５×５１６ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45053-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9508 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，６号， ８３５×６１５×７６６ mm	ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9608 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，7号， １　２１５×８３５×２７０ mm	ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9712 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，８号， １　２１５×８３５×５１６ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45056-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9812 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
収納箱，医療用，９号， １　２１５×８３５×７６６ mm	(独)ZARGES社　ZRGS SERIES Yﾎﾞｯｸｽ　45057-2 ﾌｼﾞｺｰﾜ工業㈱ 全天候型ｱﾙﾐｺﾝﾃﾅFRCｼﾘｰｽﾞ　FRC-9912 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）
注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

調達品目表（続き）

2　**性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　内装材の貼付は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品の内側（蓋部を除く。）に約１０ ｍｍ厚のウレタンを貼付したものとする。

b)　本体蓋部分のウェザーストリップは，表面塗装のときの温風乾燥［１５０ ℃×１時間（温度上昇時間を含む。）×３回］に耐える材料のものとする。

c)　外形寸法は，種類によるものとし，許容差±３ ％とする。

d)　エアバルブを側面１か所に有するものとする。

e)　５０ ｋｇのおもりを入れ，８０ ｃｍの高さからコンクリート上にコーナーから落下させたとき，有害な変形がないものとする。その後，**ＮＤＳ Ｃ ０００２**の2.2.8 区分Ｄ及びハンドルより下部を４時間水に浸け，収納箱内部に水滴が侵入しないものとする。

f)　２個の収納箱を積み重ねた状態で，１ ２００ ｋｇの荷重を上部収納箱上面に対し平均にかけたとき，両方の収納箱に有害な変形がないものとする。

g)　２個の収納箱を積み重ねた状態で，１５° 傾斜させたとき，上部の収納箱が滑り落ちないものとする。

h)　ハンドル部に対し７５ ｋｇの荷重をかけたとき，有害な変形がなくハンドルの角度が変化しないものとする。

i)　キャッチ部に対し５０ ｋｇの引っ張り荷重をかけたとき，有害な変形がないものとする。